Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use and disclosure of this document is forbidden
without expressed authorization of the issuer.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

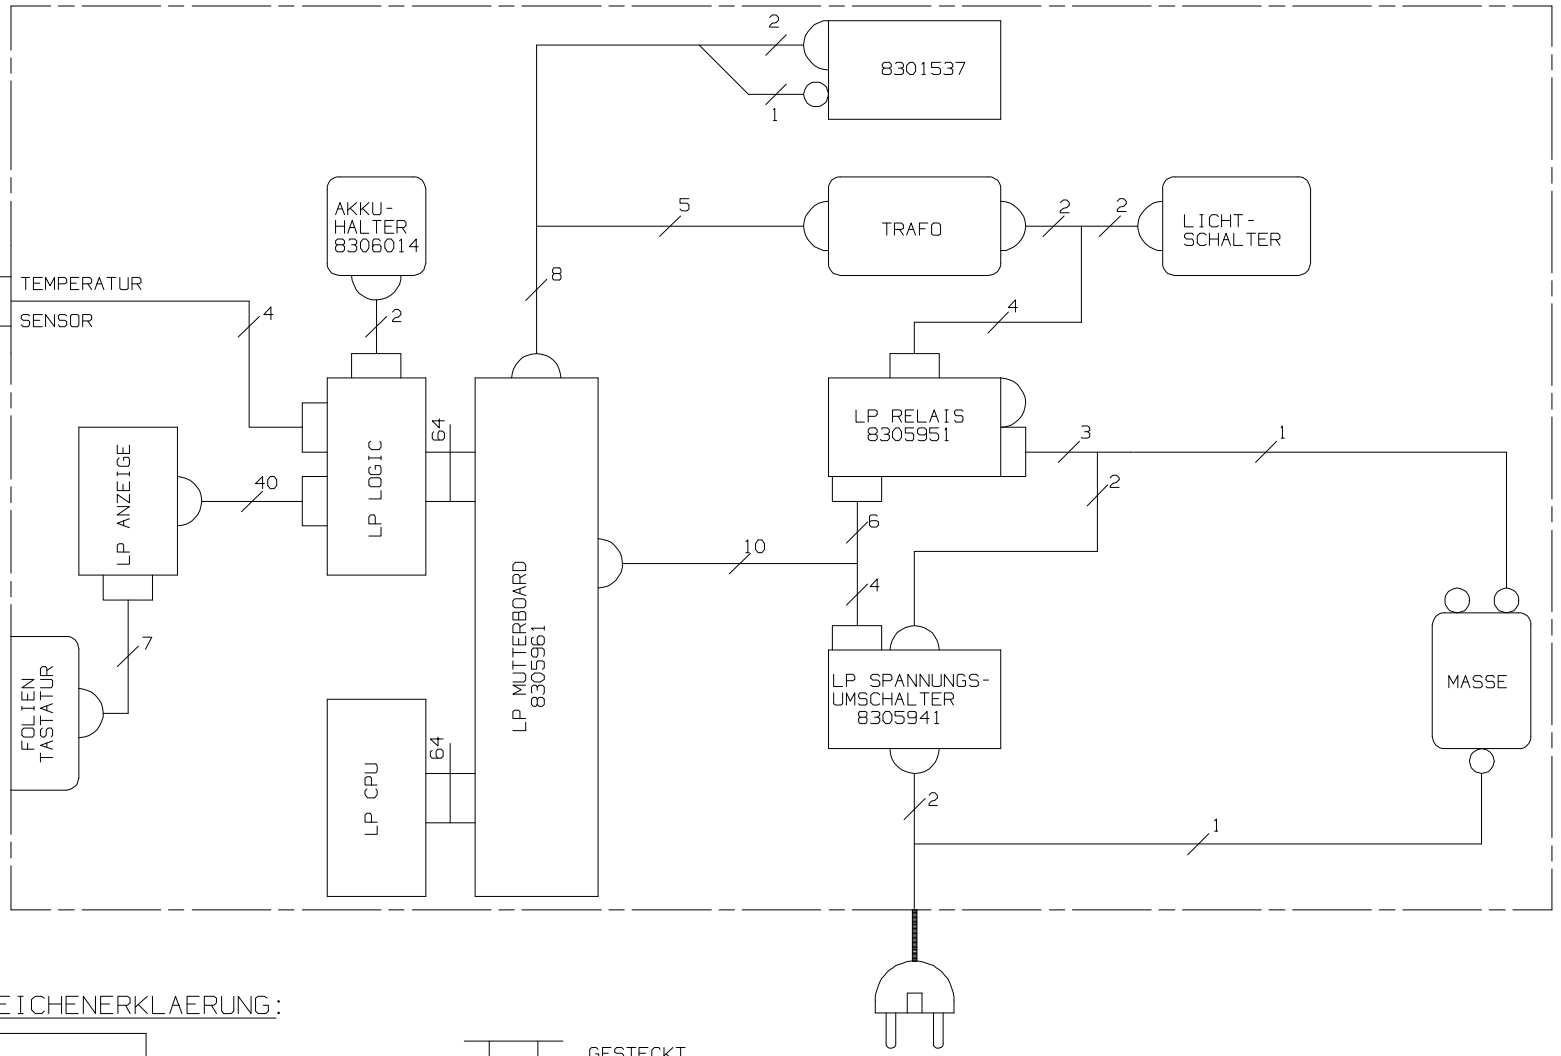

ZEICHENERKLAERUNG:

- LEITERPLATTE
- ANDERE ELEKTR. EINHEIT
- 20 — ADERZAHL
- GESTECKT
- DIREKT ANGESCHLOSSEN
- LSP — AUF LOETSTUETZPUNKT GELOETET
- GESCHRAUBT

=QA=	- -	=QB=	- -	=QC=	- -		
Werkstoff							

				0	- -		
				Aend. Ziffer	kommt vor	(114/90) Aenderungen	
Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung		1990	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
---	---	RM		Bearb	05.02.	GRUBE	
				Gepr.		SEI	
		Benennung				Zeichnungs-Nr.	
		VERBINDUNGSSCHEMA				8305928	
						Ersatz fuer	
INFO	CADRA					Ersetzt durch	

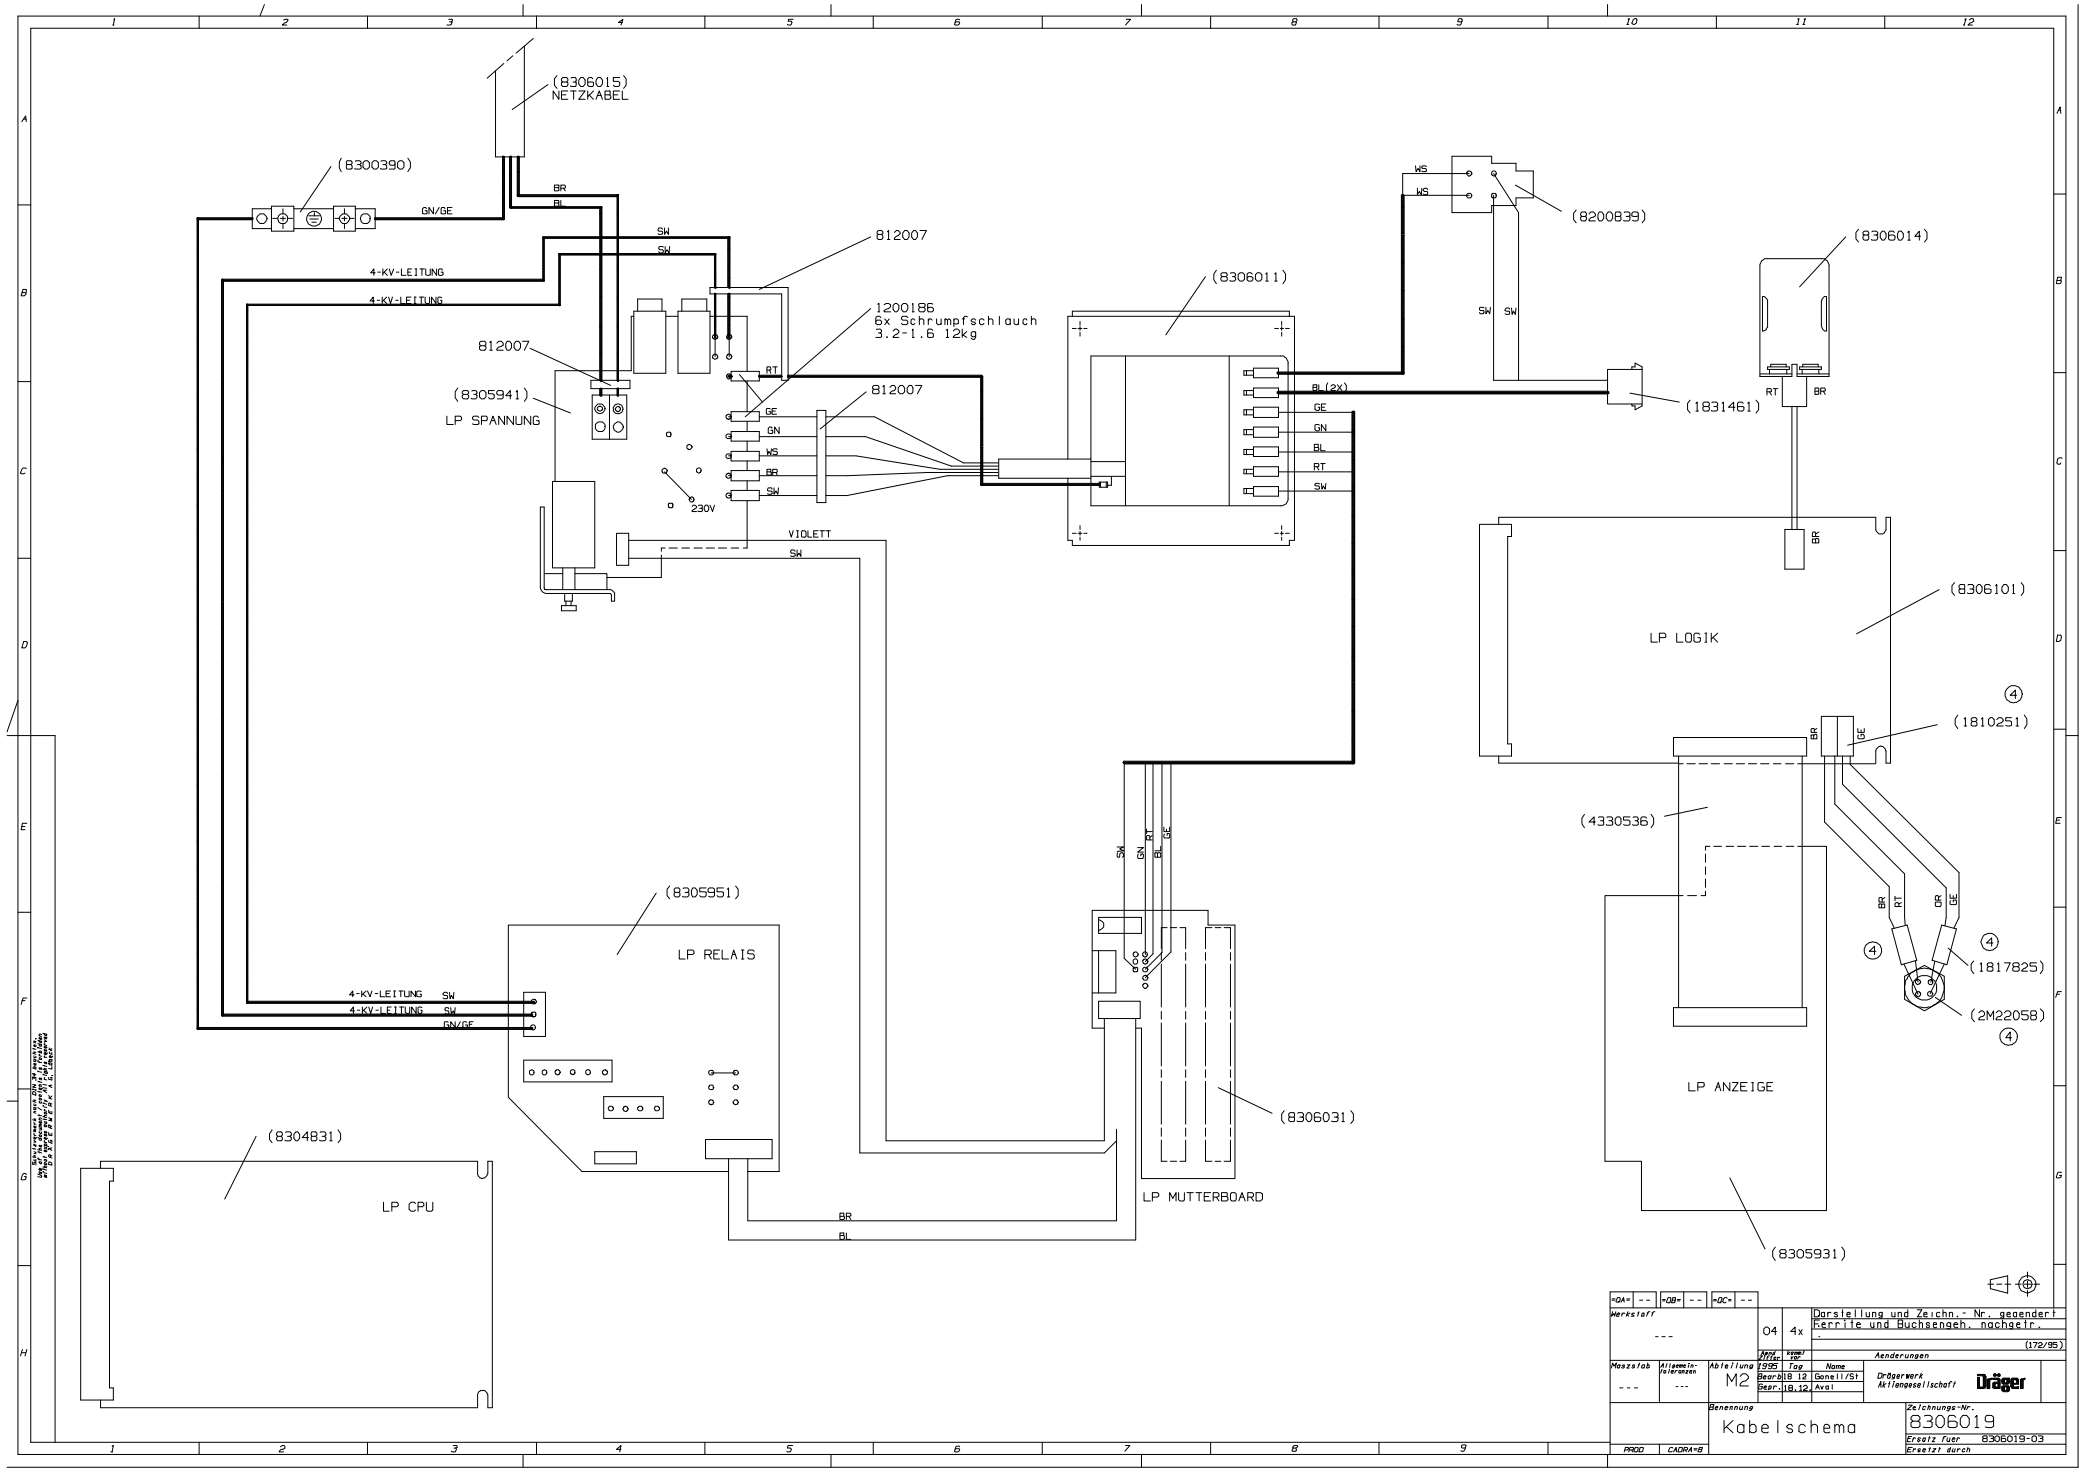
(8306015)
NETZKABEL
(8300390)
GN/GE
BR
BL
SW
SW
4-KV-LEITUNG
4-KV-LEITUNG
812007
1200186
6x Schrumpfschlauch
3.2-1.6 12kg
812007
812007
(8305941)
LP SPANNUNG
RT
GE
GN
WS
BR
SW
230V
VIOLETT
SW
(8306011)
BL(2x)
GE
GN
BL
RT
SW
WS
WS
(8200839)
SW
SW
(1831461)
(8306014)
RT
BR
BR
(8306101)
LP LOGIK
4
(1810251)
BR
GE
(4330536)
BR
RT
GR
GE
4
4
(1817825)
(2M22058)
4
LP ANZEIGE
(8305931)
SW
GN
RT
BL
GE
(8305951)
LP RELAIS
4-KV-LEITUNG SW
4-KV-LEITUNG SW
GN/GE
(8306031)
LP MUTTERBOARD
BR
BL
(8304831)
LP CPU
=QA= --- =QB= --- =QC= ---
Herkstoff

04
4x
Darstellung und Zeichn.- Nr. geaendert
Kerrite und Buchsensech. nachgetr.
(172/95)
Aenderungen
Masszstab

Allgemein-Toleranzen

Abteilung
M2
Name
Bearb 18 12 Gonell/St
Gepr. 18.12. Avai
Dräger
Drägerwerk Aktiengesellschaft
Benennung
Kabelschema
Zeichnungs-Nr.
8306019
Ersetzt fuer 8306019-03
Ersetzt durch
PROD
CADRA-B

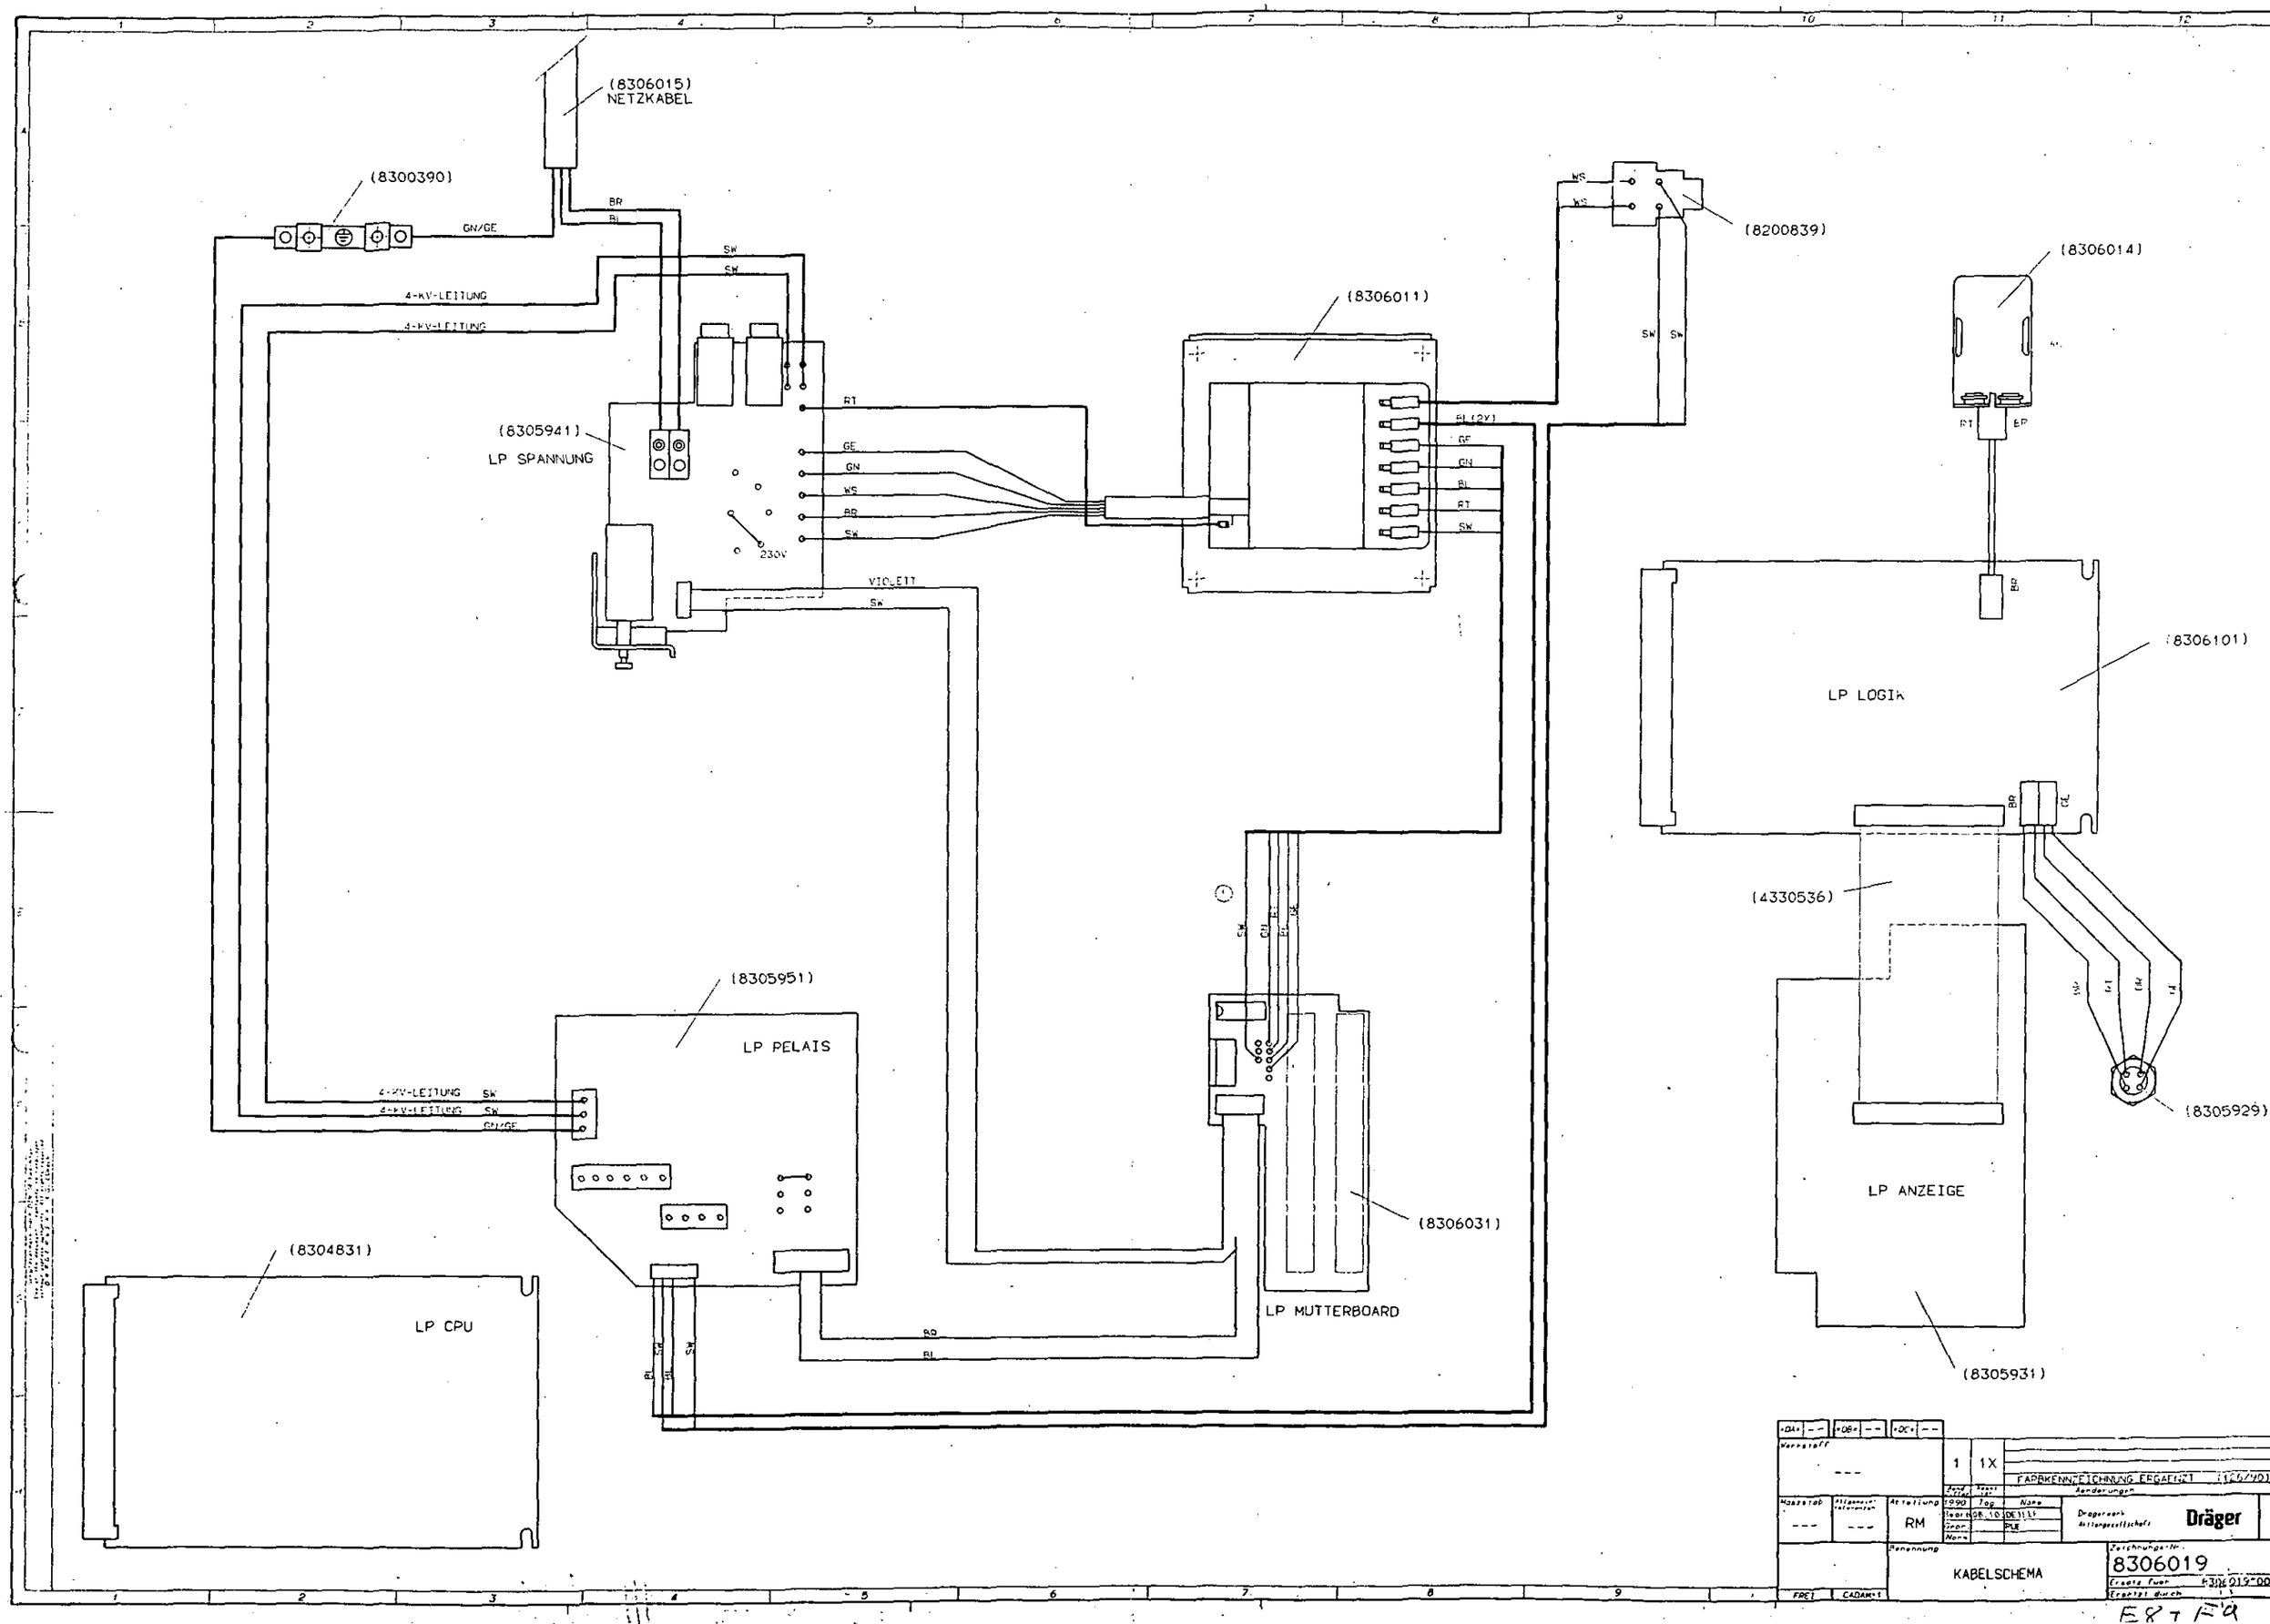

Werkstoff: ---		1	1X	FARBKENNZEICHNUNG ERGAENZT	15.07.91
Maßstab: ---	Allgemeintoleranzen: ---	Abteilung: RM	1990 Tag Name: DE 11.11	Dräger	
Benennung: KABELSCHEMA				Zeichnungsnr.: 8306019	
FREI	CADAM-1			Ersatz für: 83060 19-00	

E8 + E9